
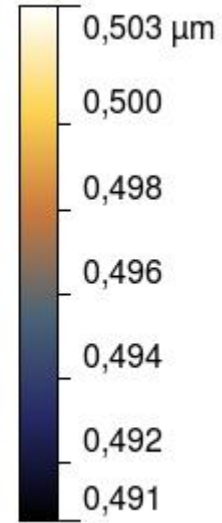
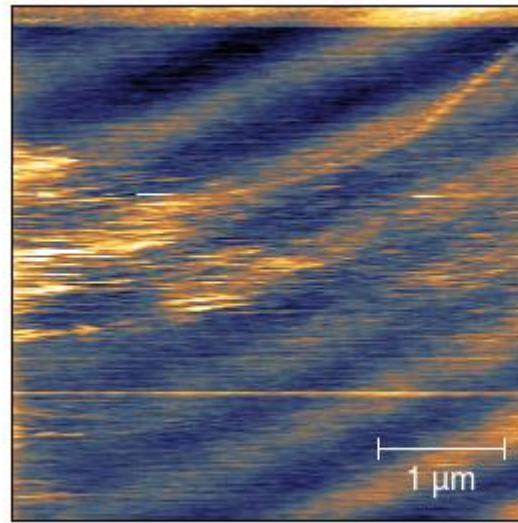
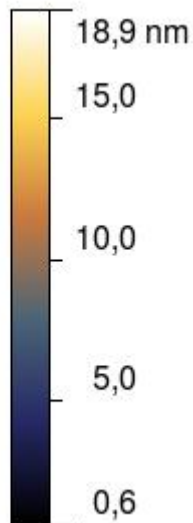
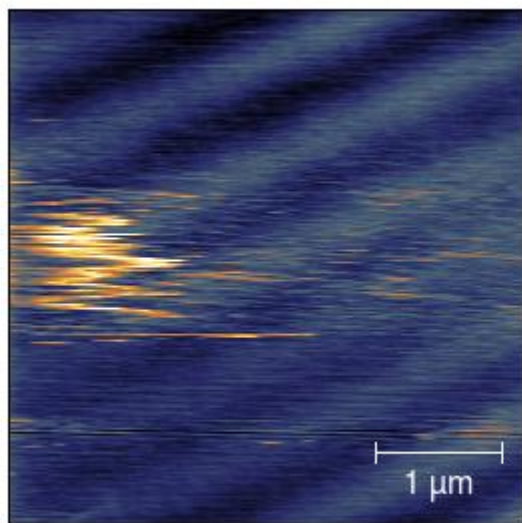
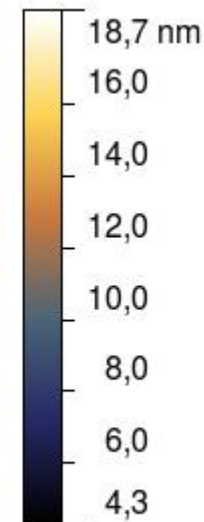
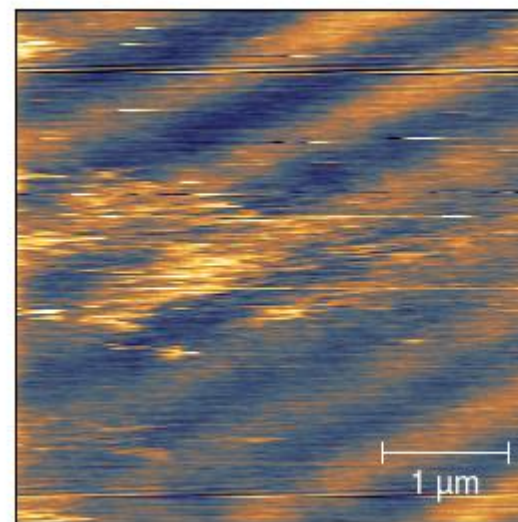
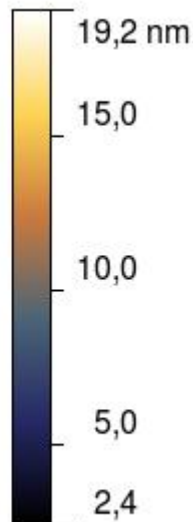








AFM Analyse von Plasmid

Messung auf Glimmer, contact Modus, Interferenzen durch Reflektionen im Glimmer

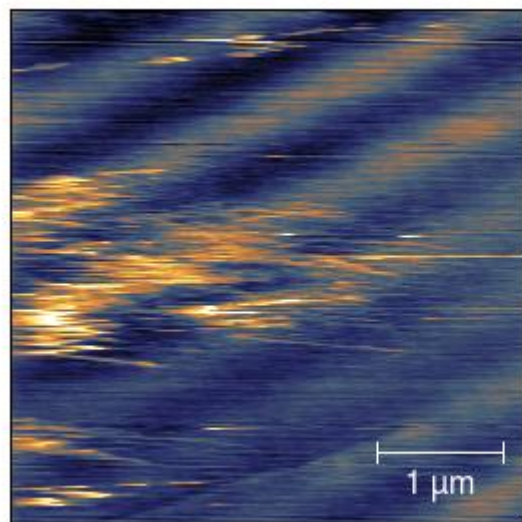









AFM Analyse von Plasmid

Messung auf MoS₂, contact Modus, ohne Plasmid

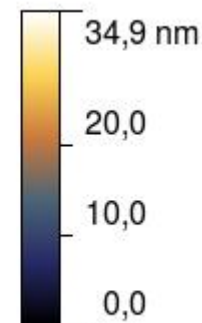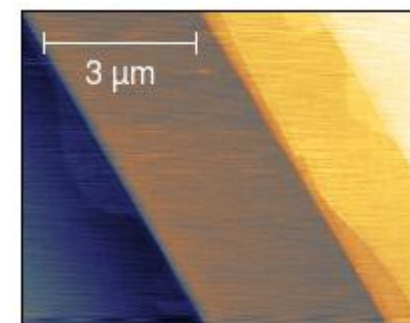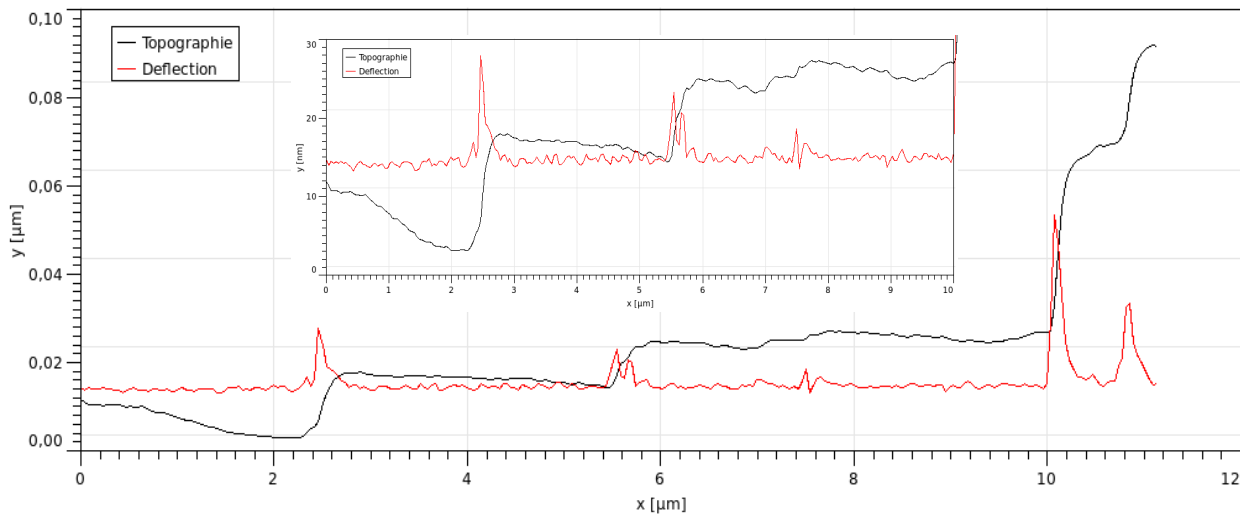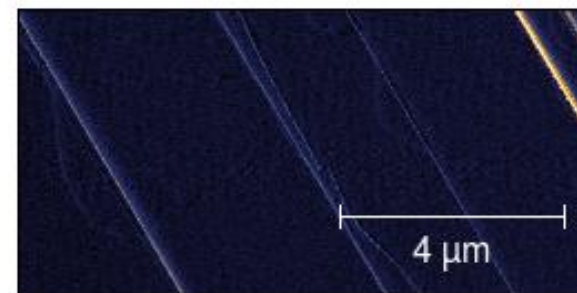


AFM Analyse von Plasmid

Messung auf MoS₂, contact Modus

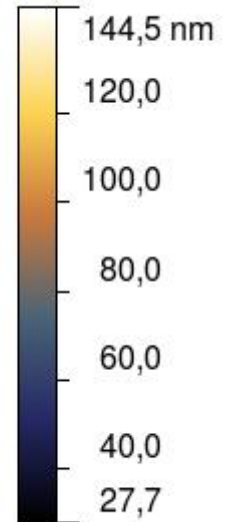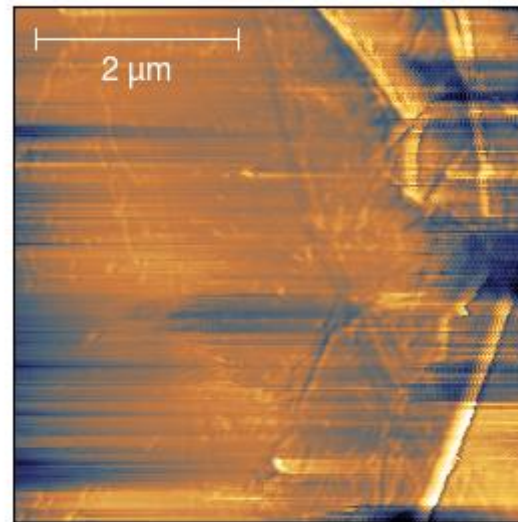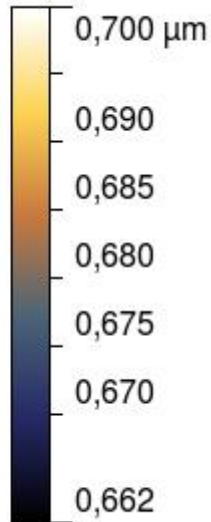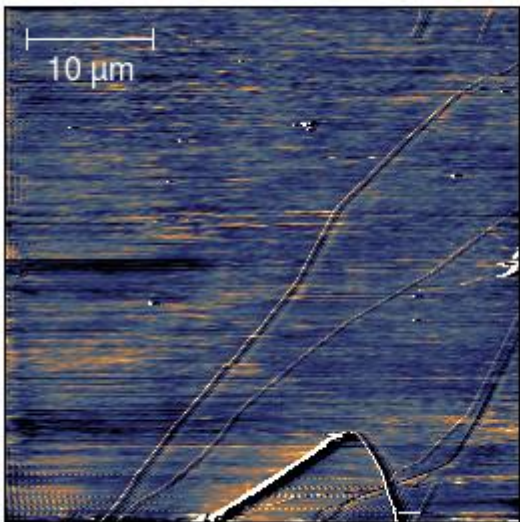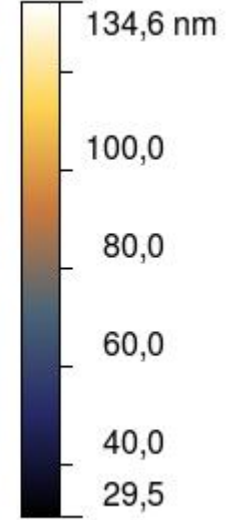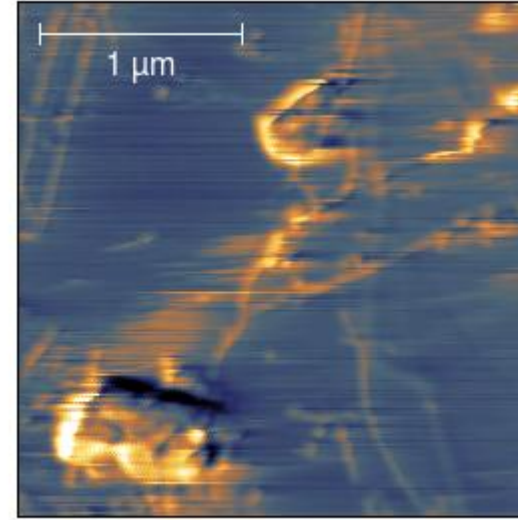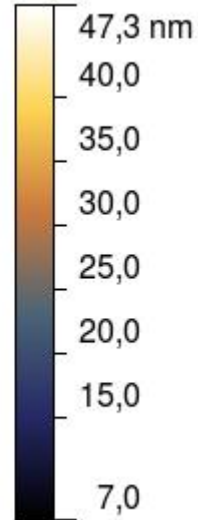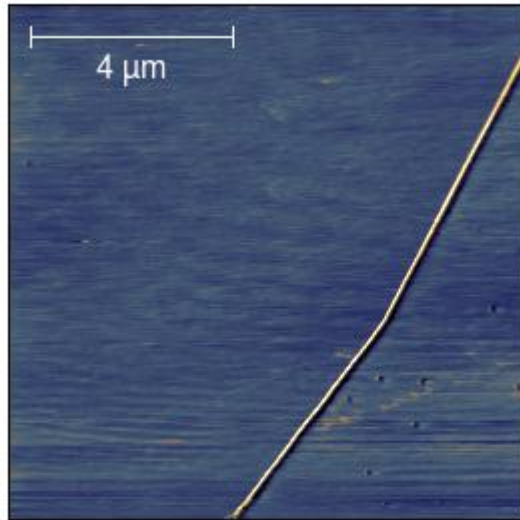

AFM Analyse von Plasmid

Messung auf MoS₂, contact Modus, Kontamination wird verschoben, DNA wird zerschnitten

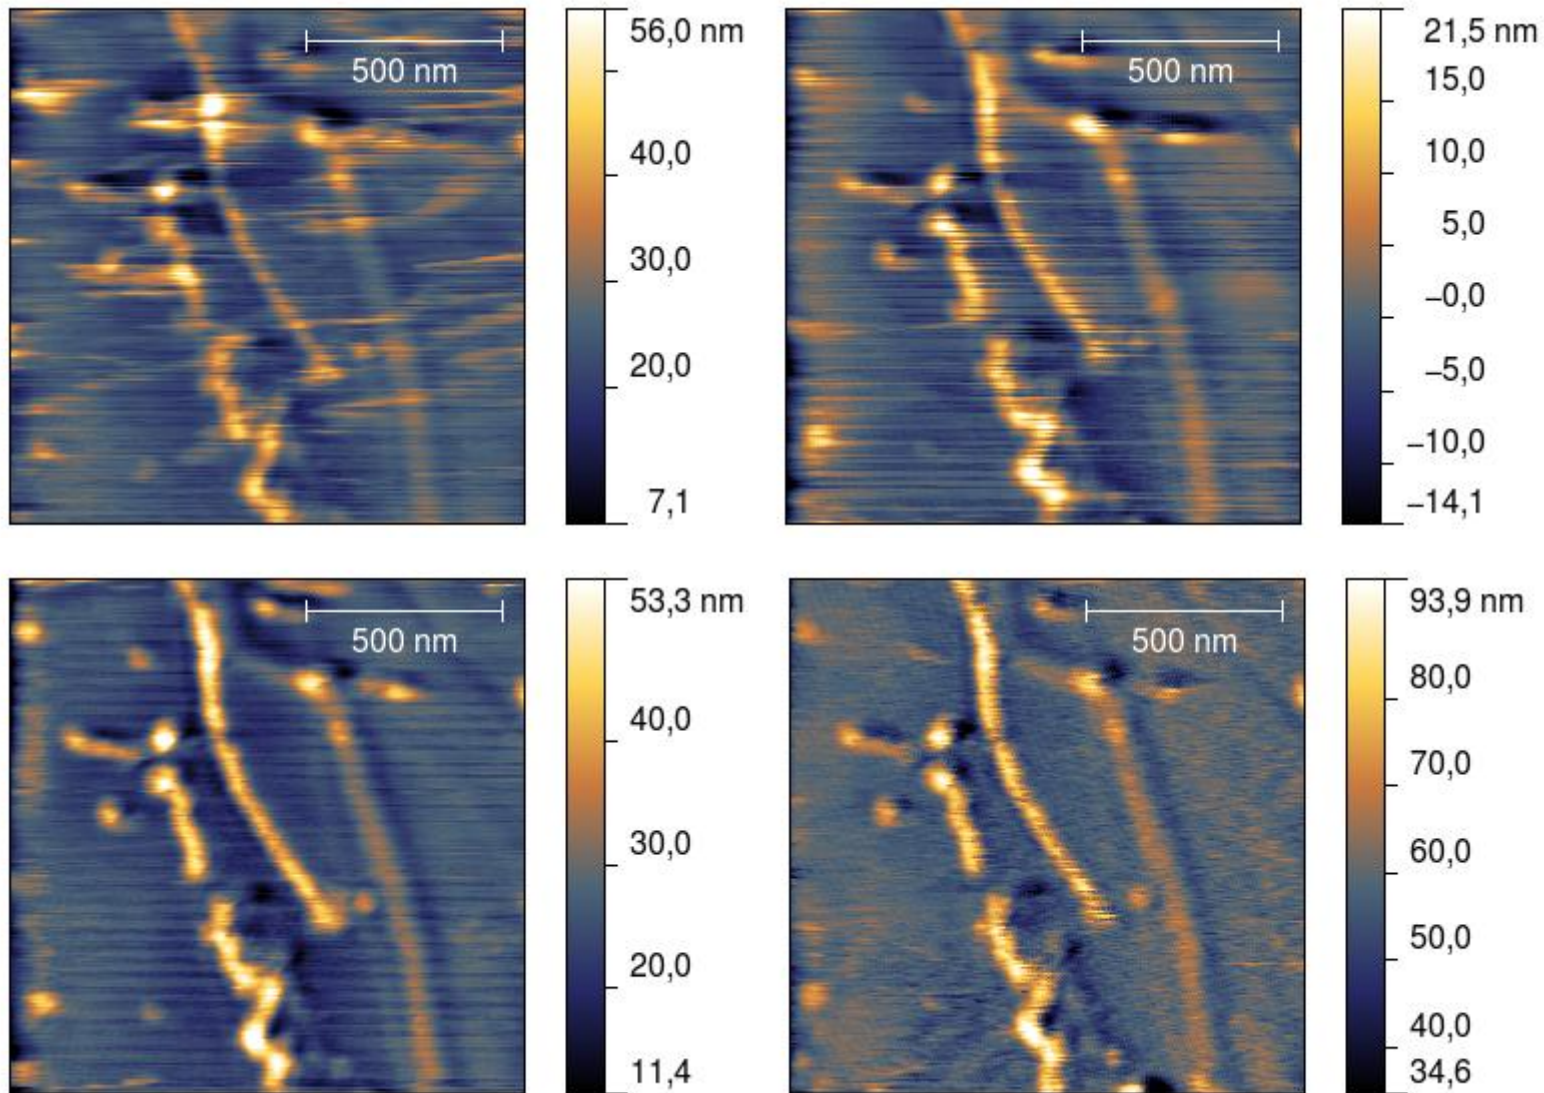

AFM Analyse von Plasmid

Messung auf MoS₂, contact Modus, zoom out zeigt vorherigen scan Bereich

